MW-100I

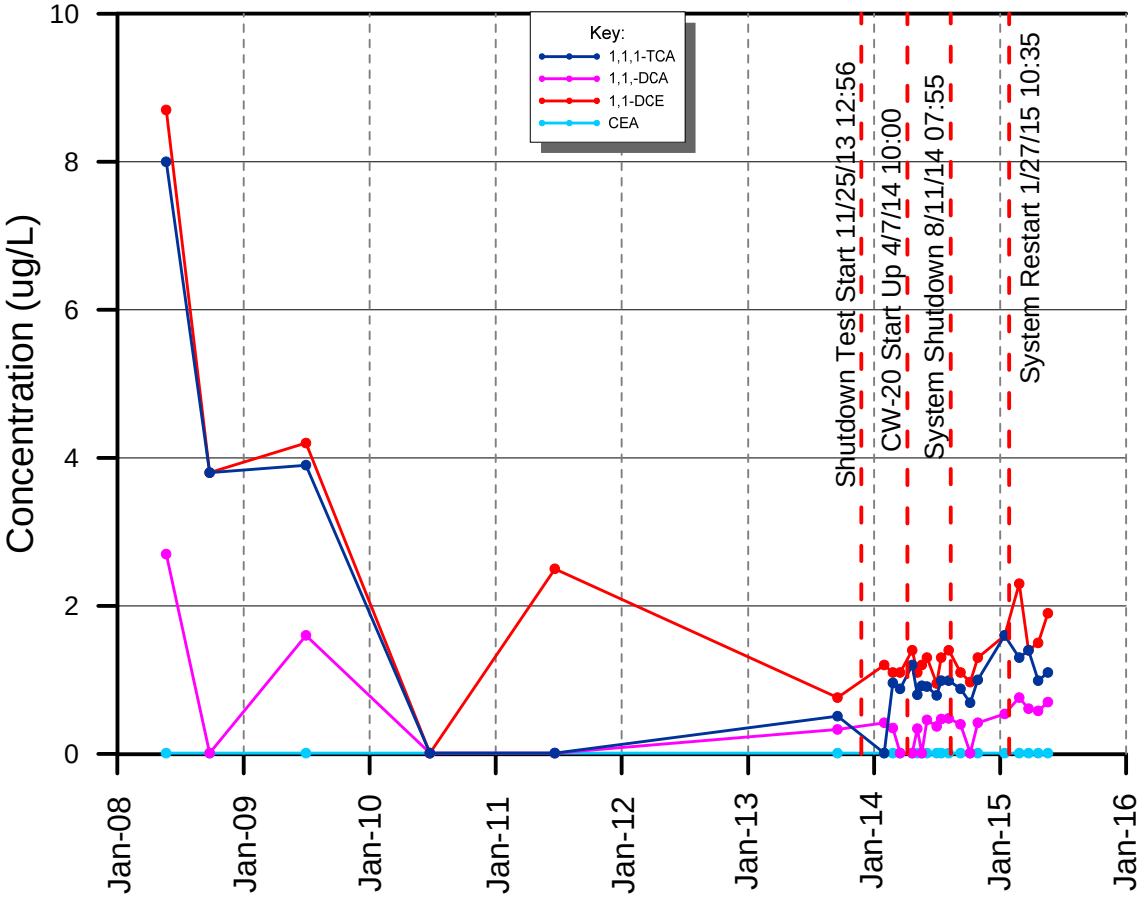
Key:
1,1,1-TCA
1,1,-DCA
1,1-DCE
CEA
Concentration (ug/L)
10
8
6
4
2
0
Shutdown Test Start 11/25/13 12:56
CW-20 Start Up 4/7/14 10:00
System Shutdown 8/11/14 07:55
System Restart 1/27/15 10:35
Jan-08
Jan-09
Jan-10
Jan-11
Jan-12
Jan-13
Jan-14
Jan-15
Jan-16

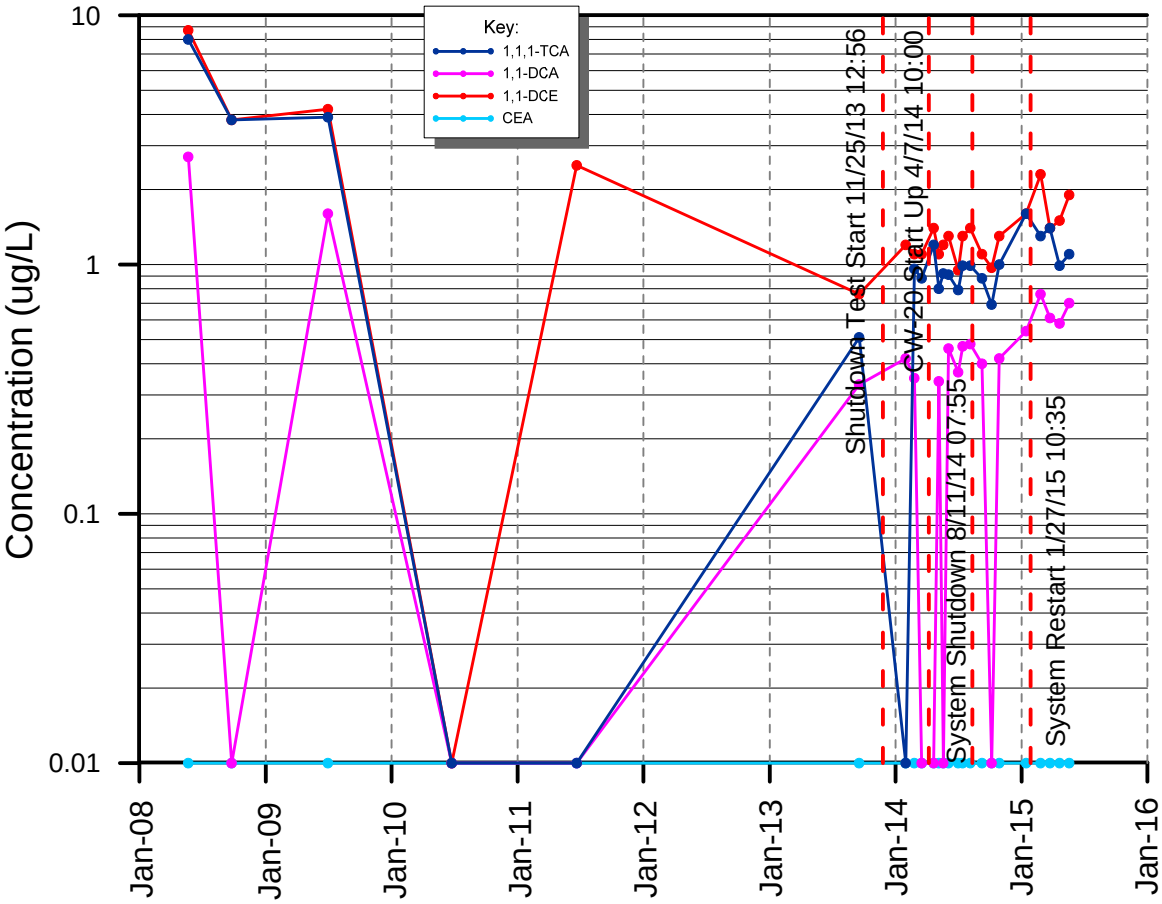
Key:
1,1,1-TCA
1,1-DCA
1,1-DCE
CEA
Concentration (ug/L)
10
1
0.1
0.01
Shutdown Test Start 11/25/13 12:56
CW-20 Start Up 4/7/14 10:00
System Shutdown 8/11/14 07:55
System Restart 1/27/15 10:35
Jan-08
Jan-09
Jan-10
Jan-11
Jan-12
Jan-13
Jan-14
Jan-15
Jan-16