MW-116

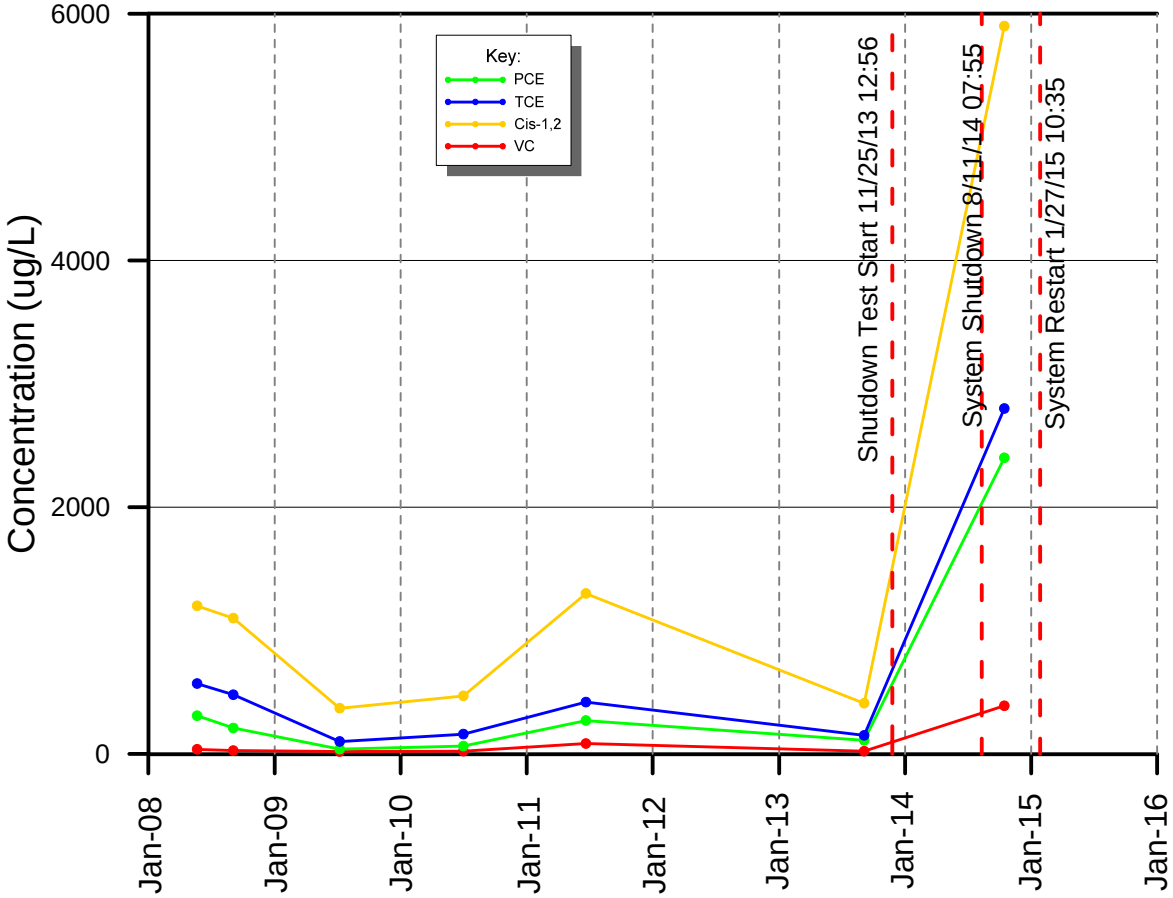
Key:
PCE
TCE
Cis-1,2
VC
Concentration (ug/L)
6000
4000
2000
0
Jan-08
Jan-09
Jan-10
Jan-11
Jan-12
Jan-13
Jan-14
Jan-15
Jan-16
Shutdown Test Start 11/25/13 12:56
System Shutdown 8/11/14 07:55
System Restart 1/27/15 10:35

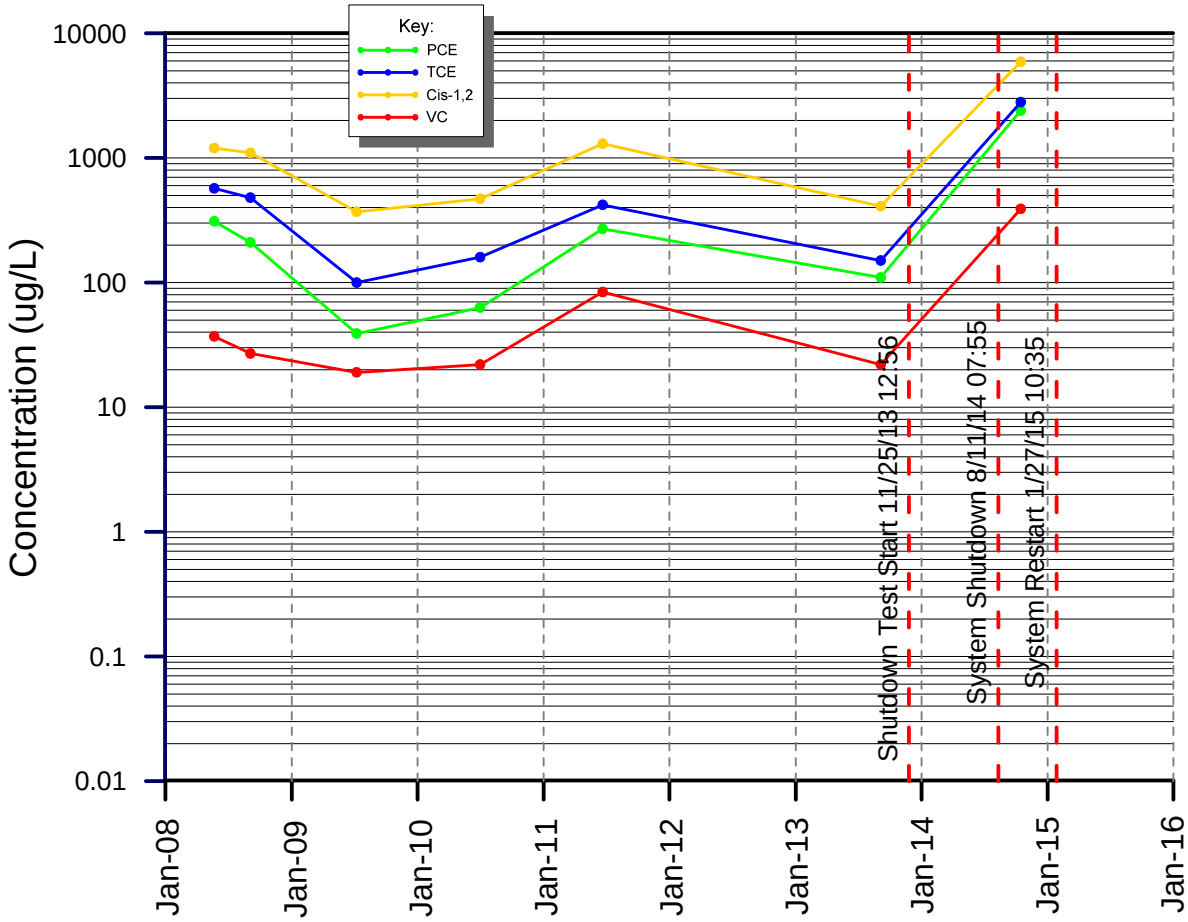
Key:
PCE
TCE
Cis-1,2
VC
Concentration (ug/L)
10000
1000
100
10
1
0.1
0.01
Jan-08
Jan-09
Jan-10
Jan-11
Jan-12
Jan-13
Jan-14
Jan-15
Jan-16
Shutdown Test Start 11/25/13 12:56
System Shutdown 8/11/14 07:55
System Restart 1/27/15 10:35